

海派系阀门自动检测台使用维护检修保养各表目录

1. 流量表

2. 压力表(普通) 3. 压力表

4. 压力表(普通) 5. 压力表

6. 压力表(普通) YPS-100PT

7. 压力表

8. 压力表

9. 压力表

10. 压力表

11. 压力表

12. 压力表(普通) 13. 压力表(普通) 14. 压力表(普通)

15. 压力表(普通) 16. 压力表(普通) 17. 压力表(普通)

18. 压力表

参数	最大限值	最小限值	单位	备注
SO ₂	400	0	mg/m ³	
NO _x	800	0	mg/m ³	
HF	25	0	mg/m ³	
HCL	150	0	mg/m ³	
湿度	40	0	%	
O ₂	25	0	%	
温度	300	0	°C	

工控机

输入量程

压力	4000	-4000	pa	
流速	40	0	m/s	
颗粒物	100	0	mg/m ³	

参数	斜率	截距	单位	备注
SO ₂	1	0	mg/m ³	
HF	1	0	mg/m ³	
NO _x	1	0	mg/m ³	
HCL	1	0	mg/m ³	
O ₂	1	0	Vol%	
温度	1	0	°C	
压力	1	0	pa	
湿度	1	0	%	
流量	1	0	m/s	
流速	1	0	mg/m ³	
颗粒物	1	0	mg/m ³	
项目	代替字母	数值	单位	备注
烟道横截面积	S	6.6	M ²	
标准过量空气系数	a	1.91		
速度场系数	K	1		

工控机

CEMS 公式
y=ax+b

说明：1、请相关负责人认真如实填写。

2、通常 a=1, b=0, 如对 a、b 值修改, 请说明原因。(仅作参考)

3、根据企业污染源应达排放标准, 确定 a 值, 以便方便超标数据。

4、过量空气系数常见的包括: 水泥行业为 1.91 (GB 4915-2014);

5、根据 HJ/T 76-2017 标准第 3.8 条的规定, CEMS 的最大测量值通常设置为高于排放源最大排放浓度的 1 至 2 倍。

污染源自动监控设施登记备案表

登记备案表单位(盖章): 华新水泥(丽江), 有限公司

法定代表人: 杜平

登记备案时间: 2019 年 11 月

联系人:

联系电话: 13988810823

联系人:

表 1 排污单位基本情况

单位名称	华新水泥(丽江)有限公司
法定代表人	杜平
地址	云南省丽江市华坪县兴泉镇兴泉社区 166 号
邮编	671801
联系人	邓代永
联系电话	13988810823

排污单位
法定代表人
地址
邮编
联系人
联系电话

表 2 社会化运行单位基本情况

单位名称	云南保隆环保科技有限公司
法定代表人	沈仕丽
地址	云南省昆明市五华区黑林铺建发曦城商业广场 A 座 34 层 3406 号
邮编	650000
联系人	谷晋
联系电话	18502906900
资质类型	有限责任公司
证书编号	91530102719492536D
有效期限	2001 年 01 月 18 日至 2021 年 01 月 17 日

单位名称
法定代表人
地址
邮编
联系人
联系电话
资质
资质

表 3 废气排污口基本情况

排污口名称	华新水泥(丽江)有限公司
排气筒高度 (m)	60m
采样位置	距离地面 10 米平台

表 4 废气自动监控设施基本情况

设备名称	污染源烟气自动监测设备		
设备出厂编号	19170001		
生产商	西克麦哈克（北京）仪器有限公司		
代理商	/		
生产许可证编号	京制 01080366 号 01		
环保产品认证编号	CCAEP1-EP-2017-412		
适用性检测报告文号	质（认）字 No. 2017-107		
(附复印件)			
设备型号	MCS100F 型		
通过验收时间	2019 年 11 月		
测量项目	SO ₂ 、NO _x 、O ₂ 、颗粒物、HF、HCl、烟温、压力、流速、流量、湿度		
测试方法	直接抽取测量法		
气水分离器冷凝器温度			
气水分离器滤芯正常颜色	/		
量程	SO ₂ : 0—400mg/m ³ NO _x : 0—800mg/m ³ O ₂ : 0—25% 颗粒物: 0—100 mg/m ³ HF: 0—25mg/m ³ HCl: 0—150mg/m ³ 烟温: 0—300° C 流速: 0—10m/s 压力: ±1kPa 湿度: 0—100%		
分辨率	SO ₂ : 2mg/m ³ , NO _x : 2mg/m ³ , O ₂ : 0.1%, 颗粒物: 0.1mg/m ³ , HF: 1mg/m ³ , HCl: 1mg/m ³ , 流速: 0.1m/s, 压力: ±1kPa, 湿度: 0.1%		

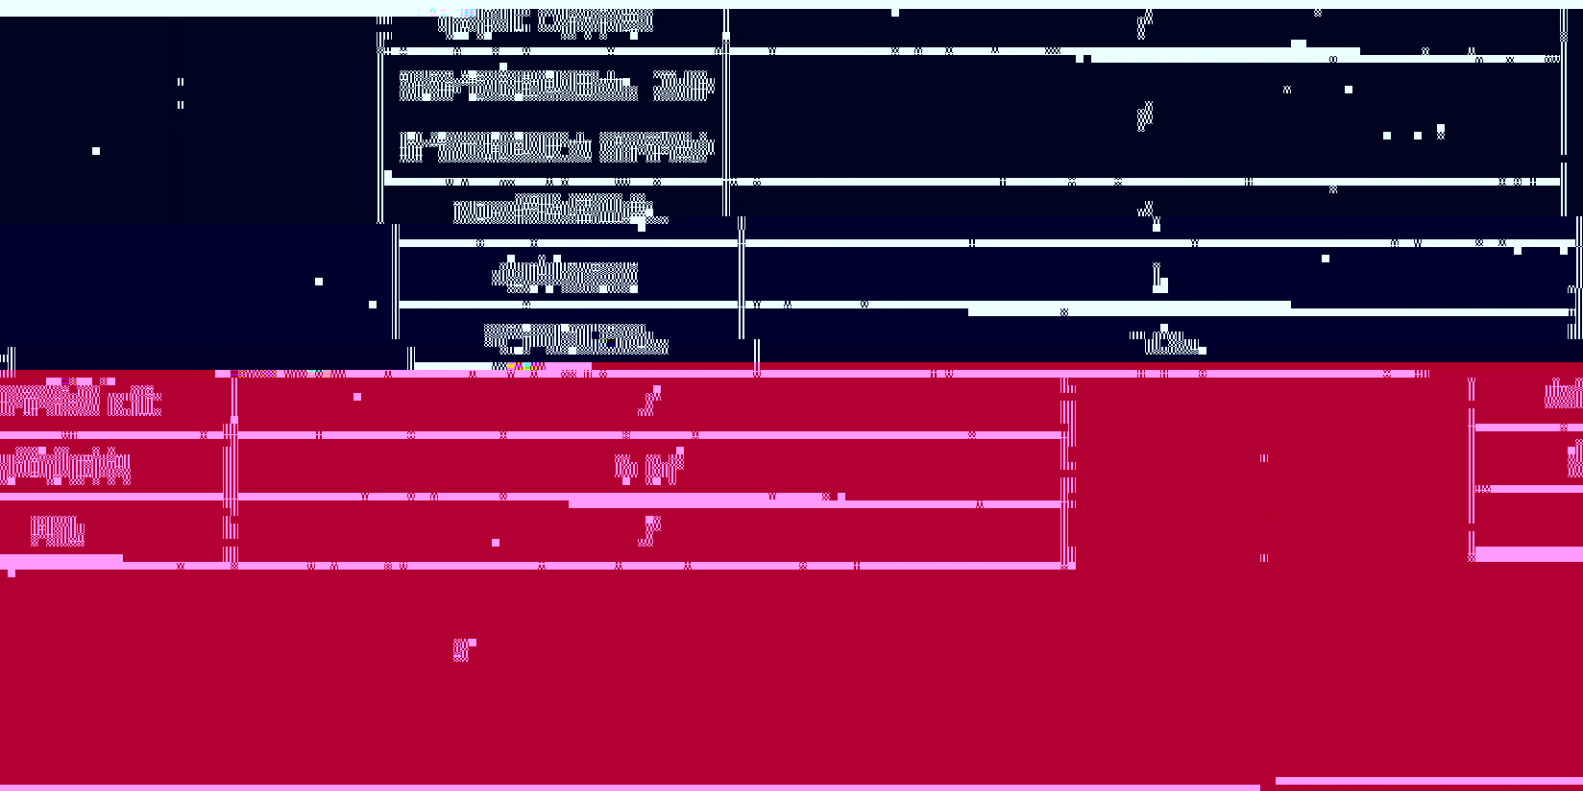


表 5 数据采集仪基本情况

设备名称	数据收集传输仪
设备出厂编号	756877X-02-46958
生产商	广州博控自动化技术有限公司
代理商	云南深隆环保有限公司
生产许可证编号	/
环保产品认证编号	CCAEP1-EP-2017-123

数据收集单元：数字输入通道数量、模拟量输入通道数量、开关量输入通道数量	数字输入通道数量：1个
通信协议	《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》（HJ 212-2017）
存储容量	8G